

Infektionsdiagnostik

Mononukleose Test

zum qualitativen Nachweis von IM-Antikörpern (Infektiöse Mononukleose) im frühen Stadium der Infektion in Vollblut-, Serum- oder Plasmaproben.

Infektiöse Mononukleose (Pfeiffersches Drüsenfieber) ist eine akute Viruserkrankung, die durch das Epstein-Barr-Virus (EBV) verursacht wird.

Die IM wird durch Speichelkontakt übertragen, etwa in Kindergärten oder beim Küssen (Kusskrankheit). Die Infektion kann auch durch Tröpfcheninfektion erfolgen. Durch Schnelltests kann eine infektiöse Mononukleose bereits während der ersten Woche diagnostiziert werden.



Ihre Vorteile im Überblick


- Qualitatives Ergebnis in **5 Minuten**
- Hohe Sensitivität (>99,9 %) und Spezifität (99,5 %)
- Lagerung bei 2 bis 30°C
- Lange Haltbarkeit von bis zu 24 Monaten
- Nur eine Pufferlösung
- Komplettes Zubehör inkl. Positiv- und Negativkontrolle

Mononukleose Test

Ein schneller immunochromatographischer Test zum qualitativen Nachweis von IM-Antikörpern im frühen Stadium der Infektion in Vollblut-, Serum- oder Plasmaproben.

Testdurchführung

1. Gekühltes Probenmaterial und Testkomponenten auf Raumtemperatur bringen.
2. Öffnen Sie den Folienbeutel durch Aufreißen an der Einkerbung. Entnehmen Sie die Testkassette. Legen Sie den Test auf eine saubere, ebene Fläche.
3. Beschriften Sie die Kassette mit Patientennamen oder ID-Nummer.
4. Geben Sie 1 Tropfen der Probe mit der Pipette in den Probenschacht S und 1 Tropfen Puffer aus der Tropflasche hinzu.

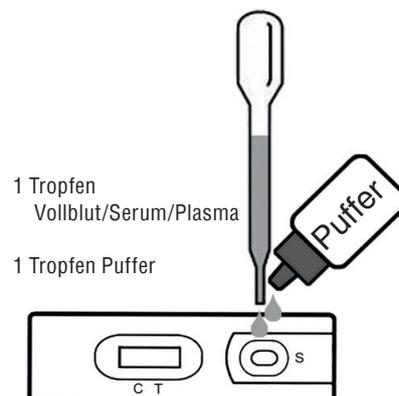

Lesen Sie das Testergebnis 5 Minuten nach Zugabe des Probenmaterials ab.
Nach 10 Minuten ist das Testergebnis nicht mehr interpretierbar!

Ergebnisbewertung



Negativ

Erscheint nur eine farbige Linie in der Kontrollzone C und keine farbige Linie in der Testzone T, ist der Test negativ auf IM Antikörper.



Positiv

Erscheinen zwei farbige Linien, eine in der Kontrollzone C und eine in der Testzone T, ist der Test positiv auf IM Antikörper. Die Intensität der Testlinie T kann abhängig von der Antikörper-Konzentration in der Probe variieren. Jedes Anzeichen einer Linie sollte als positives Ergebnis betrachtet werden.



Ungültig

Erscheint keine farbige Linie in der Kontrollzone C, ist der Test in jedem Fall ungültig. Der Test sollte mit einer neuen Testkassette wiederholt werden.



Produkt	Art.-Nr.	Packungsinhalt	Testform	Testmaterial	Testdauer	PZN
Mononukleose Test	0270112	25 Tests	Kassette	Vollblut/Serum/Plasma	5 Minuten	1139579